Smart Check™ by ROHO®

Manuale d'uso

Fornitore: Questo manuale deve essere dato all'utente di questo prodotto.

Operatore (utente o assistente): Prima di usare questo prodotto leggere le istruzioni e conservarle per il futuro.

s h a p e f i t t i n g t e c h n o l o g y®

Indice

Uso previsto Informazioni importanti per la sicurezza	2-3
Legenda	4
Specifiche tecniche	5
Componenti	6
Informazioni generali	7
Istruzioni d'uso in modalità Smart Setup	8-9
Istruzioni per verificare la regolazione	10
Istruzioni d'uso in modalità Optional Setup Istruzioni per il controllo eseguito con la mano	11
Istruzioni per resettare le informazioni (Hard Reset) Disconnessione e custodia Risoluzione dei problemi	12
Pulizia e disinfezione Sostituzione della batteria Smaltimento	13
Procedure di reso Registrazione del prodotto Informazioni di contatto Garanzia limitata	14

ROHO, Inc.
100 North Florida Avenue, Belleville, Illinois 62221-5429
Negli USA: 800-851-3449 • Fax 888-551-3449 • cc@roho.com
Fuori dagli U.S.A: 618-277-9150 • Fax 618-277-6518 • intl@roho.com
www.roho.com

© 2015 ROHO, Inc.

I seguenti sono marchi commerciali e marchi commerciali registrati di ROHO, Inc.: ROHO®, Smart Check™, shape fitting technology®, e Sensor Ready™.

I prodotti di questo manuale possono essere coperti da uno o più brevetti e marchi commerciali statunitensi e internazionali. Smart Check™ by ROHO® è in attesa di brevetto.

ROHO, Inc. ha una politica di miglioramento continuo dei prodotti e si riserva il diritto di modificare questo documento.

Uso previsto

Smart Check™ by ROHO® (Smart Check) è un sistema di feedback per cuscino che serve per assistere l'utente memorizzando un range di gonfiaggio durante la regolazione del cuscino. Durante i controlli dei livelli di gonfiaggio successivi, Smart Check indicherà se sono necessarie ulteriori regolazioni per rimanere all'interno del range salvato.

Smart Check deve essere collegato ad un cuscino a comparto unico ROHO® già predisposto alla tecnologia Sensor Ready™ (Cuscino Sensor Ready).

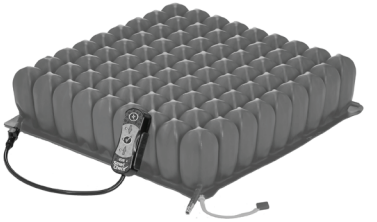

⚠ Informazioni importanti per la sicurezza

- Leggere attentamente e completamente le istruzioni prima dell'uso del prodotto.
- I dispositivi medici ROHO devono fare parte di in un regime di cura globale. ROHO, Inc. raccomanda che sia un medico a valutare i prodotti in base alle esigenze mediche e terapeutiche ed alle condizioni generali di salute dell'individuo (ad esempio, potenziali reazioni allergiche). L'uso di questo dispositivo non elimina la necessità di un controllo di routine del prodotto e di tutte le normali attività associate alla protezione della cute e dei tessuti molli (spostamento del peso per attenuare la pressione, controllo della cute, cura generale della cute, ecc.)

Avvertenze

- **Controllare il gonfiaggio frequentemente, almeno una volta al giorno, usando lo Smart Check o facendo un controllo con la mano.**
- **Se il prodotto sembra non trattenere l'aria, consultare la sezione RISOLUZIONE DEI PROBLEMI del manuale fornito col cuscino; o contattare il servizio assistenza.**
- **TENERE LE BATTERIE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI E DI QUALSIASI PERSONA CHE POSSA AVERE LA TENDENZA A METTERE IN BOCCA OGGETTI NON COMMESTIBILI. L'ingerimento o l'inalazione può causare lesioni serie o morte. Contattare IMMEDIATAMENTE l'assistenza medica di emergenza.**
- **FARE ATTENZIONE in presenza di bambini per evitare il pericolo di strangolamento. Scollegare lo Smart Check se non in uso e conservarlo in un luogo sicuro ed accessibile.**
- **Usare un accessorio (ad esempio, una pompa o una fodera del cuscino) diverso da quello fornito da ROHO, Inc., potrebbe non essere sicuro e potrebbe invalidare la garanzia del prodotto.**
- **NON modificare lo Smart Check o eventuali componenti. Questa operazione potrebbe causare guasti al prodotto e invalidare la garanzia.**

⚠ Informazioni importanti per la sicurezza (continuazione)

Avvertenze (continuazione)

- **NON usare in presenza di anestetici infiammabili e/o in un ambiente ricco di ossigeno. Questo aumenta il rischio di incendio o esplosione.**
- **Se il cuscino sembra instabile durante la regolazione in modalità Smart Setup, eseguire resettare le informazioni (Hard Reset) e poi ripetere la regolazione in modalità Smart Setup . Se ci si sente ancora instabili, eseguire una regolazione in modalità Optional Setup e consultare un operatore sanitario.**
- **Il cuscino DEVE essere della misura corretta per l'utente. SE NON LO È, lo Smart Check non è in grado di trovare la gamma di gonfiaggi durante la regolazione in modalità Smart Setup, riducendo o eliminando i vantaggi del cuscino e aumentando il rischio per la cute o gli altri tessuti molli.**
- **Tutte le procedure d'uso relative allo Smart Check descritte in questo manuale possono essere eseguite dall'utente o da un assistente. Se non si è in grado di eseguire le operazioni descritte in questo manuale, chiedere assistenza.**
- **PERICOLO DI USTIONE: Se la temperatura ambiente supera i 47°C (117°F), NON restare a contatto con la superficie del prodotto per più di (10) minuti.**
- **Lo Smart Check DEVE essere usato SOLO con una fodera per cuscino ROHO compatibile. L'uso di una fodera diversa può interferire con la precisione delle funzioni dello Smart Check.**
- **NON eseguire la manutenzione dello Smart Check se in uso. Questo potrebbe causare un funzionamento non corretto.**
- **Regolare il cuscino nelle condizioni ambientali abituali. Eseguire la procedura di controllo se le condizioni ambientali, compresa temperatura e altitudine, cambiano in modo significativo.**

Attenzione

- Ogni giorno: Controllare la disconnessione rapida, il tubo e l'alloggiamento del dispositivo Smart Check per verificarne l'usura o rottura e garantire il collegamento dei componenti interni. **NON** continuare ad usare lo Smart Check se alcune parti sono danneggiate o non possono essere collegate in modo sicuro.
- ROHO, Inc. consiglia di far controllare lo Smart Check periodicamente da un tecnico qualificato.
- **NON** immergere lo Smart Check in liquidi, in quanto si rischia di danneggiare il dispositivo.
- Proteggere lo Smart Check da urti che potrebbero danneggiare e/o rompere il dispositivo.
- **NON** esporre il prodotto ad elevata temperatura, fiamme vive o ceneri calde.
- **NON** usare la valvola di gonfiaggio o altri componenti dello Smart Check come impugnatura per trasportare o tirare il cuscino.
- L'eccessiva esposizione a ozono può danneggiare alcuni materiali utilizzati nella produzione di questo prodotto, influire sulla prestazione dello stesso ed invalidare la garanzia.
- L'esposizione prolungata a luce UV / luce solare può scolorire le etichette del prodotto.

Legenda

Avvertenza	
Fare riferimento alle istruzioni d'uso.	
Luogo di produzione.	
Conservare all'asciutto.	
Asciugare a mano.	
Asciugare all'aria.	
Non usare candeggiante	
Batteria scarica: luce di colore ambra	

Limite di temperatura	
Limite di umidità (relativa, non condensa)	
Limite di pressione atmosferica	
Pericolo di soffocamento	
Non gettare nei rifiuti domestici.	
Identificazione utente	
IEC 60601-1: Parte applicata di tipo BF	

Specifiche tecniche

Condizioni per la custodia

Condizioni operative

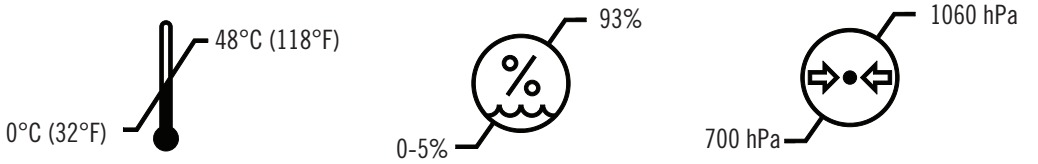

Limite di altitudine (al di sopra del livello del mare); Inferiore a -410 m Superiore a 3185 m

- Smart Check: policarbonato con maschera in poliestere
- Custodia: polistirene
- Tubo: poliuretano
- Disconnessione rapida: acetale
- Questo prodotto è conforme a RoHS2.
- Smart Check è una parte applicata di tipo BF. Smart Check è stato testato e soddisfa le norme IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 e IEC 60601-1-11; è certificato secondo lo standard CAN/CSA C22.2 N. 60601-1. Nessuna interferenza elettromagnetica è causata da Smart Check e interferisce con Smart Check.
- Durata di utilizzo previsto: 5 anni
- Batterie: tempo di utilizzo tipico di un (1) anno
- Smart Check è un dispositivo di classe IP54 (protetto da polvere e schizzi d'acqua).

Componenti

Contenuto della confezione: Smart Check™ by ROHO®, istruzioni Smart Check, scheda di registrazione, custodia

Per informazioni sul cuscino, fare riferimento al *Cuscino a comparto unico ROHO® con tecnologia Sensor Ready™ Manuale d'uso*.

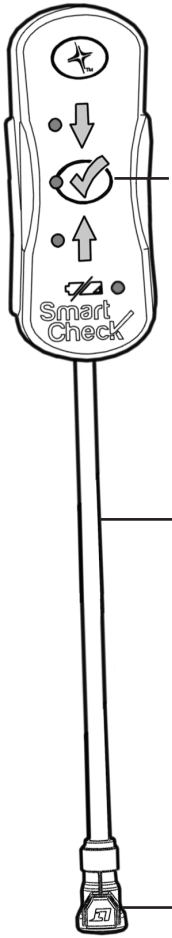

Maschera dello Smart Check :

Far riferimento alle istruzioni per i dettagli della maschera.

Tubo

Meccanismo di disconnessione rapida

Manuale d'uso

Scheda di registrazione del prodotto

Custodia

Informazioni generali

Questa pagina spiega come usare il dispositivo Smart Check per trovare, memorizzare e controllare la regolazione di gonfiaggio del cuscino.
Leggere attentamente prima di usare lo Smart Check.

Regolazione in modalità Smart Setup e procedura di Controllo:

1. Seguire le Istruzioni D'uso in modalita' Smart Setup. Lo Smart Check troverà e memorizzerà l'impostazione di gonfiaggio del cuscino.

Seguire le Istruzioni per verificare la regolazione. Quando si preme il tasto Check (Controllo), lo Smart Check indicherà se sarà necessario regolare il cuscino.

Regolazione di gonfiaggio corretta del cuscino: **A)** sprofondare nel cuscino e **B)** "galleggiare" sulla base del cuscino.

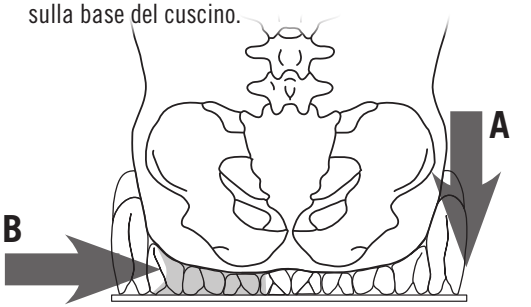

La regolazione in modalità Optional Setup è un'alternativa alla regolazione in modalità Smart Setup.
La regolazione Optional Setup è preferibile nelle seguenti situazioni:

- Nel caso in cui uno specialista della seduta determini un'immersione particolare ed un livello di avvolgimento specifico per l'utente.
- Se l'utente deve soddisfare esigenze particolari (come nel caso di una postura asimmetrica grave) che vanno oltre la regolazione di immersione e di avvolgimento rilevata dallo Smart Check durante la regolazione in modalità Smart Setup.
- Se il cuscino è usato su una superficie imbottita (come un sedile da capitano).

Regolazione in modalità Optional Setup (e Controllo)

1. Trovare la regolazione di gonfiaggio del cuscino desiderata senza usare il dispositivo Smart Check. (Fare riferimento al *Cuscino a comparto unico ROHO® con tecnologia Sensor Ready™ Manuale d'uso*.)
2. Seguire le Istruzioni d'uso in modalità Optional Setup, usando lo Smart Check per memorizzare la regolazione di gonfiaggio.
3. Seguire le Istruzioni per verificare la regolazione. Quando si preme il tasto Check (Controllo), lo Smart Check indicherà se sarà necessario regolare il cuscino.

⚠ **La regolazione in modalità Optional Setup non deve essere usata se la persona pesa meno di 40 kg.**

IMPORTANTE!

- **Eseguire la regolazione (nella modalità Smart Setup o nella modalità Optional Setup) quando si usa Smart Check per la prima volta.**
- **Eseguire di nuovo la regolazione Smart Setup o Optional Setup se si verificano le seguenti modifiche: 1) un'altra persona usa lo Smart Check; 2) viene usata una carrozzina diversa o un cuscino diverso; o 3) la persona riporta modifiche fisiologiche (ad esempio, perdita o aumento di peso). Prima di eseguire una nuova regolazione, cancellare la regolazione dello Smart Check; vedere le Istruzioni per resettare le informazioni (Hard Reset).**
- **Eseguire di frequente la procedura di Controllo, almeno una volta al giorno!**

Istruzioni d'uso in modalità Smart Setup

Lo Smart Check troverà e memorizzerà la regolazione di gonfiaggio ideale per voi, seduti sul vostro cuscino, e sulla vostra carrozzina. **NOTA:** I risultati possono variare in base al tipo di corporatura.

- **Eseguire i seguenti passaggi nelle condizioni ambientali abituali.**
- **Il cuscino DEVE essere gonfiato al massimo per iniziare la regolazione in modalità Smart Setup. È possibile sentirsi temporaneamente instabili; in tal caso procedere con attenzione.**
- **La persona DEVE essere seduta sul cuscino nella carrozzina prima di usare lo Smart Check.**

Simboli e spie dello Smart Check

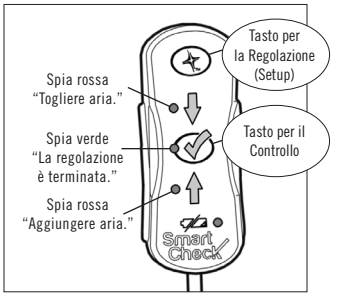
Tasto per la Regolazione (Setup)
Spia rossa "Togliere aria."
Tasto per il Controllo
Spia verde "La regolazione è terminata."
Spia rossa "Aggiungere aria."
Smart Check

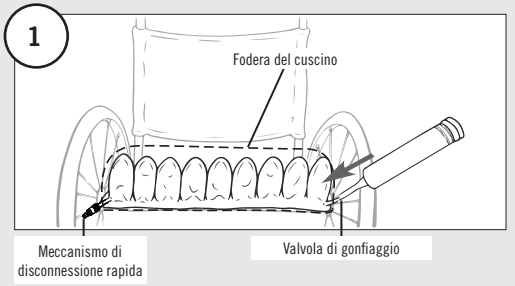

1. Mettere il cuscino sulla carrozzina. Mettere l'ugello della pompa sulla valvola di gonfiaggio. *Se si usa una fodera per cuscino, mettere la fodera sul cuscino prima di gonfiare.*

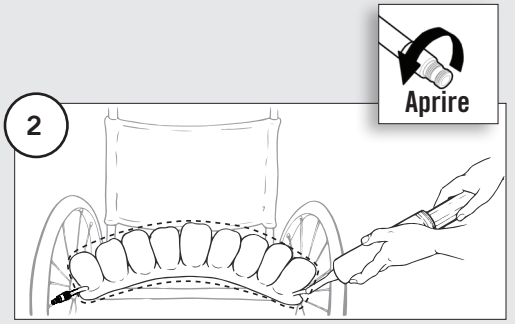

2. Aprire la valvola di gonfiaggio. Gonfiare del tutto il cuscino finché non si inarca. Chiudere la valvola di gonfiaggio. Togliere la pompa.

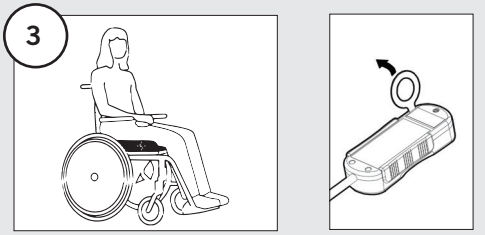

3. Sedere sulla carrozzina nella posizione abituale. Tirare per rimuovere la linguetta *(solo al primo utilizzo).*

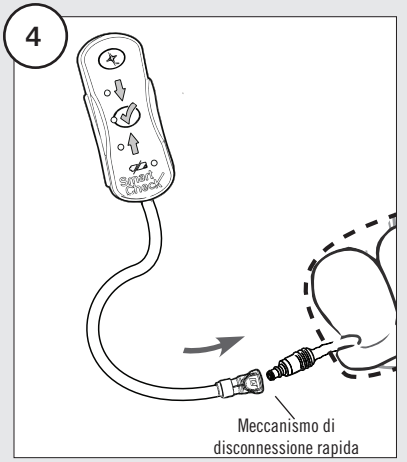

4. Accertarsi che la valvola di gonfiaggio sia chiusa. Applicare lo Smart Check al cuscino. Si sentirà un "clic" quando la connessione è avvenuta.

Istruzioni d'uso in modalità Smart Setup (continuazione)

5a.

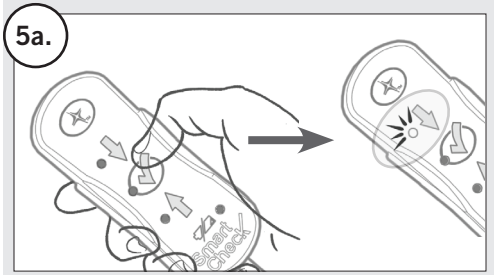

5a. Premere il tasto per il Controllo (Check ✓). Quando compare la spia della freccia rossa ↓ rivolta verso il basso, procedere al passaggio 5b.

NOTA: Se compare la spia della freccia rossa rivolta ↑ verso l'alto quando si preme il tasto per il Controllo: 1) Accertarsi che il dispositivo di disconnessione rapida sia ben collegato, e 2) Aprire la valvola di gonfiaggio, aggiungere altra aria, chiudere la valvola di gonfiaggio e premere di nuovo il tasto per il Controllo ✓. *Ripetere finché non compare la spia della freccia rossa rivolta verso il basso.*

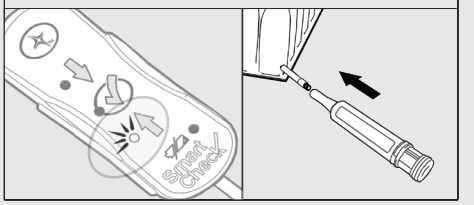

5b.

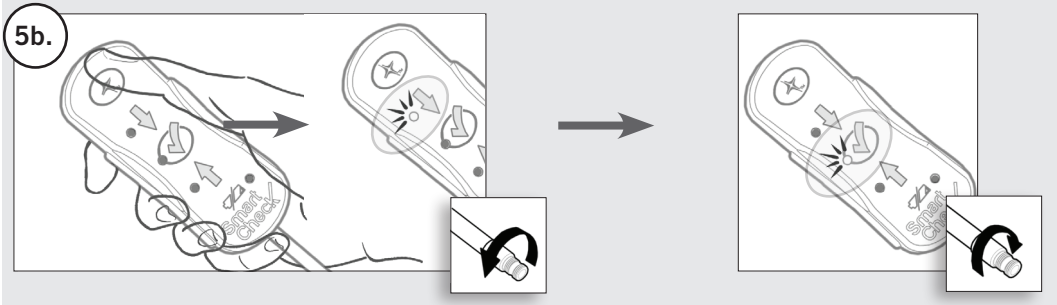

5b. Premere (ma non tenere premuto) il tasto per la Regolazione. Las pia della freccia rossa ↓ rivolta verso il basso ora **lampeggerà**. Aprire la valvola di gonfiaggio, rilasciare aria (circa 30 - 60 secondi)* e attendere che lampeggi la spia verde.

Se la spia della freccia rossa ↓ rivolta verso il basso smette di lampeggiare prima di aver aperto la valvola, tornare a 5a.

***Per garantire una lettura precisa:** Restare fermi ed evitare di limitare il flusso dell'aria quando si rilascia l'aria dal cuscino.

Quando compare la spia verde lampeggiante, chiudere la valvola di gonfiaggio. La spia verde indica che la regolazione è completa.

Il cuscino ora è regolato.
(Poi: Vedere Istruzioni per verificare la regolazione).

⚠ **Conservare lo Smart Check in un luogo sicuro ed accessibile. Vedere le istruzioni di DISCONNESSIONE E CUSTODIA.**

Istruzioni per verificare la regolazione

Eseguire un controllo dopo aver completato la regolazione (in modalità Smart Setup o in modalità Optional Setup).

Simboli e spie per il Controllo

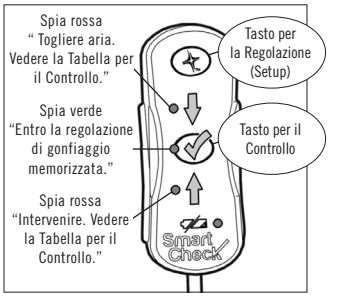

Come eseguire un controllo:

1. Si deve stare seduti nella posizione abituale.
2. Premere il tasto per il Controllo.
3. Far riferimento alla tabella sotto riportata.

- **Eseguire di frequente la procedura di Controllo, almeno una volta al giorno!**
- **Se si usa una fodera durante la regolazione del cuscino, la stessa fodera deve essere usata durante il controllo.**
- **Eseguire un controllo se si verifica una variazione significativa dell'altitudine.**

Tabella per il controllo

NOTA: Dopo aver eseguito un controllo con il dispositivo, è possibile scegliere se eseguire un ulteriore controllo con la mano per prendere famigliarità con il proprio range di gonfiaggio. Vedere le Istruzioni per il controllo eseguito con la mano.
NOTA: È possibile aggiungere o rimuovere una piccola quantità di aria e rimanere ancora la nel range di regolazione di gonfiaggio corretto del vostro cuscino. Lo Smart Check memorizza la regolazione di gonfiaggio del cuscino con dello spazio per la regolazione.

Spia	Stato	Azione
	Il cuscino è entro la regolazione di gonfiaggio memorizzata.	Non è necessaria altra azione.
Spia	**Possibili cause**	**Azione**
	Il vostro peso potrebbe essere distribuito in modo irregolare.	Spostate il peso per far circolare l'aria del cuscino, quindi premere il tasto per il Controllo per avere una nuova lettura.
	Il meccanismo di disconnessione rapida non è collegato bene al cuscino.	Accertarsi che la connessione sia corretta, quindi premere il tasto per il Controllo per avere una nuova lettura. Vedere Risoluzione dei problemi in questo manuale.
	Il cuscino necessita di più aria.	Aprire la valvola e aggiungere altra aria al cuscino (da 6 a 10 pompate). Chiudere la valvola. Premere il tasto per il Controllo per ottenere una nuova lettura. Ripetere come necessario. **Se non si riesce a eseguire le regolazioni, interrompere l'uso fino a quando non si riceve assistenza.**
	Il cuscino o il meccanismo di disconnessione rapida sul cuscino presenta una lenta perdita d'aria.	Vedere Risoluzione dei problemi nel *Manuale d'uso del cuscino a comparto unico ROHO® con tecnologia Sensor Ready™* o contattare il servizio di assistenza.
Spia	**Causa**	**Azione**
	Il cuscino ha troppa aria.	Aprire la valvola e togliere aria dal cuscino finché non compare la spia verde. Chiudere la valvola. **Se non è possibile eseguire questa operazione, contattare l'assistenza.**

Istruzioni d'uso in modalità Optional Setup

La regolazione in modalità Optional Setup è un'alternativa alla regolazione in modalità Smart Setup. Per maggiori informazioni, consultare la sezione Informazioni generali.

Prima parte: Regolare il cuscino senza usare lo Smart Check

1. Eseguire la procedura per resettare le informazioni (Hard Reset). Vedere Istruzioni per resettare le informazioni (Hard Reset).
   NOTA: Al primo utilizzo togliere la linguetta della batteria.
2. Gonfiare il cuscino e metterlo sulla carrozzina. Sedere sul cuscino nella posizione abituale. Regolare il cuscino seguendo le istruzioni di regolazione del cuscino nel *Manuale d'uso del cuscino a comparto unico ROHO® con la tecnologia Sensor Ready™*.
3. Eseguire un controllo con la mano per confermare l'immersione e l'avvolgimento. (Vedere le Istruzioni per il controllo eseguito con la mano.)

Simboli e spie della regolazione in modalità Optinal Setup

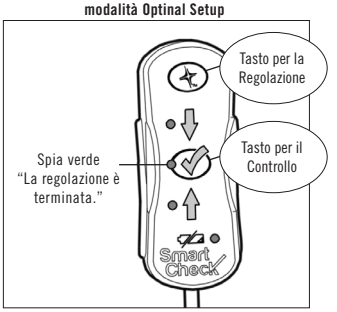

Seconda parte : Salvare la regolazione con lo Smart Check

⚠ Eseguire i seguenti passaggi nelle condizioni ambientali abituali.



4. Verificare che lo Smart Check sia collegato al cuscino. Si sentirà un "clic" quando la connessione è avvenuta.

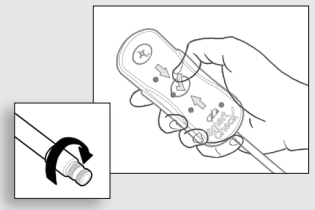

5. Accertarsi che la valvola di gonfiaggio sia chiusa. Premere il tasto per il Controllo (Check ✓) per attivare lo Smart Check. Comparirà una spia rossa ↑ o ↓. **NON** aggiungere o rimuovere aria.

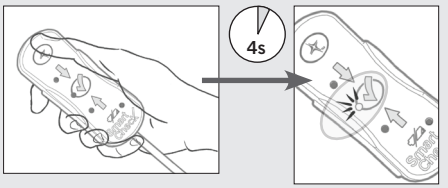

6. Premere e tenere premuto il tasto per la Regolazione per quattro (4) secondi finché non compare una spia verde. La spia verde indica che la regolazione è completata.

Il vostro cuscino adesso è regolato.
(Passaggio successivo: vedere le Istruzioni per verificare la regolazione*).*

⚠ Conservare lo Smart Check in un luogo sicuro ed accessibile. Vedere le istruzioni di Disconnessione e custodia.

Istruzioni per il controllo esequito con la mano

Usare questa guida per regolare il cuscino durante la regolazione in modalità Optional Setup.
Si consiglia un controllo manuale anche dopo aver eseguito la regolazione in modalità Smart Setup in modo da avere un riferimento nel caso fosse necessario regolare il cuscino senza lo Smart Check (ad esempio, se il dispositivo è stato smarrito).

1. Mettere la mano tra se stessi e il cuscino. Sentire la prominenza ossea più bassa. Si dovrebbero poter muovere leggermente le dita. La distanza consigliata tra la persona e la superficie della seduta può variare da 1,5 cm a 2,5 cm.
2. Se sembra che il cuscino abbia troppa aria o non abbastanza aria, regolare come necessario e vedere le Istruzioni per verificare la regolazione e la sezione Informazioni generali.

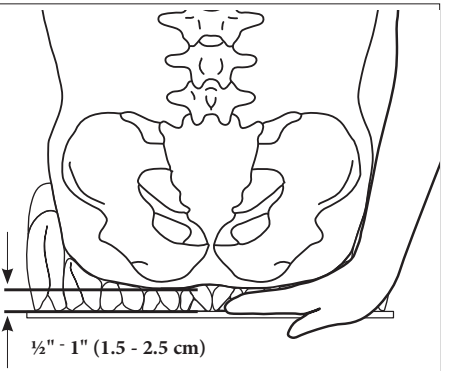

Istruzioni per resettare le informazioni (Hard Reset)

Prima di eseguire una nuova regolazione, cancellare la regolazione sullo Smart Check facendo un reset delle informazioni in memoria. **NOTA:** Lo Smart Check può essere collegato o staccato se quando si esegue il Reset.

1. Accertarsi che non vi siano spie fisse o lampeggianti.
2. Premere e tenere premuti simultaneamente il tasto per il Controllo ED il tasto per la Regolazione per cinque (5) secondi. Ogni spia lampeggerà una volta per indicare che la regolazione precedente è stata rimossa.



Disconnessione e custodia

Per disconnettere lo Smart Check dal cuscino: Premere verso il basso l'aggancio grigio, quindi staccare.

Per conservare lo Smart Check: Staccare e conservare Smart Check in un luogo sicuro ed accessibile se non in uso (ad esempio, nella custodia fornita con lo Smart Check).

⚠ **Verificare che lo Smart Check non prema contro il corpo.**

Risoluzione dei problemi

Problema	Azione
Nessuna spia compare su Smart Check dopo aver premuto il tasto per il Controllo.	Verificare che la linguetta sia stata rimossa dal vano batteria. Controllare il tipo di batteria e l'orientamento. Sostituire le batterie se necessario. Contattare il servizio assistenza se il problema persiste.
Regolazione in modalità Smart Setup: dopo aver premuto il tasto per il Controllo, lo Smart Check mostra ancora la spia rossa "Aggiungi aria" ↑ mentre è assodato che il cuscino è troppo gonfio e che il meccanismo di disconnessione rapida è ben collegato.	Controllare l'anello a O sul meccanismo di disconnessione rapida del cuscino per usura o guasto. In caso di guasto, contattare il servizio assistenza. Controllare il cuscino un'eventuale lieve perdita d'aria. Vedere Risoluzione dei problemi nel *Manuale d'uso del cuscino a comparto unico ROHO® con tecnologia Sensor Ready™*.
Regolazione in modalità Optional Setup: non compare una spia verde dopo aver premuto e tenuto premuto il tasto per la Regolazione per quattro (4) secondi.	Ripetere la seconda parte delle D'uso in modalità Optional Setup. Se ancora non compare una spia verde, è possibile che la regolazione in modalità Optional Setup non sia compatibile con le vostre esigenze fisiche o preferenze. Fare riferimento alle Informazioni Generali e alle Istruzioni d'uso in modalita' Smart Setup, o contattare il medico o il servizio di assistenza.
Avete bisogno di assistenza per l'uso o la manutenzione dello Smart Check o riscontrate problemi imprevisti.	Contattare l'assistenza clienti.

Pulizia e disinfezione

- **La pulizia e la disinfezione sono procedimenti separati. La pulizia deve precedere la disinfezione.**
- **Se usato dalla stessa persona, pulire e disinfettare il prodotto quando necessario. Prima dell'uso da parte di un'altra persona, disinfettare e controllare che il prodotto sia funzionante.**
- **Osservare le linee guida di sicurezza sulle etichette di pulizia e disinfezione del prodotto.**
- **Lo Smart Check non deve essere pulito con acetone, MEK, toluene o smacchiatori adesivi.**
- **NON immergere lo Smart Check in liquidi..**

Come pulire: Pulire lo Smart Check con un detersivo delicato e un panno pulito e morbido o una spugna. Asciugare all'aria.

Per disinfettare: Pulire lo Smart Check con un detersivo disinfettante non sbiancante. Asciugare all'aria.

Sterilizzazione: Lo Smart Check non è imballato in condizioni sterili, né è destinato ad essere sterilizzato prima dell'uso. Le alte temperature accelerano l'invecchiamento e possono causare danni all'assemblaggio del prodotto.

Sostituzione della batteria

La spia di batteria esaurita indica che le batterie devono essere sostituite.





- *Lo Smart Check manterrà in memoria la regolazione salvata dopo la sostituzione della batteria.*
- *Per preservare la durata della batteria, lo Smart Check passa automaticamente alla modalità di riposo se non in uso.*
- *Durata prevista delle batterie: un (1) anno.*

1. Staccare lo Smart Check dal cuscino dal meccanismo di disconnessione rapida.
2. Usare un cacciavite Philips con un'impugnatura non conduttiva per svitare la vite ed aprire il coperchio della batteria.
3. Usare il cacciavite per sganciare le batterie.
4. Far riferimento a "+" ed inserire due (2) nuove batterie a cella alcaline 1.5 volt (LR44, AG13 o equivalenti).
5. Chiudere il coperchio delle batterie.
6. Stringere la vite. **NOTA:** Se la vite non è avvitata completamente, le batterie potrebbero essere esposte a umidità e danneggiare il prodotto.

TENERE LE BATTERIE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI E DI QUALSIASI PERSONA CHE ABBIA LA TENDENZA A METTERE IN BOCCA OGGETTI NON COMMESTIBILI. L'ingerimento o l'inalazione può causare lesioni serie o morte. Contattare IMMEDIATAMENTE l'assistenza medica di emergenza.

Smaltimento

Smaltire il prodotto e/o componenti secondo le norme applicabili vigenti, (compreso lo smaltimento di rifiuti elettronici). **NON INCENERIE.**

Procedure di reso
Contattare la ROHO prima di rendere il vostro prodotto. I prodotti da rendere necessitano di previa autorizzazione da parte della ROHO, Inc., devono essere nuovi e non utilizzati, e sono soggetti ad un addebito per il loro ricondizionamento.

Registrazione del prodotto
Spedire la registrazione del prodotto allegata o registrare il prodotto su www.roho.com.

Informazioni di contatto
Negli USA: Telefono: 800-851-3449 • Fax: 888-551-3449
Servizio di garanzia: warranty@roho.com • Servizio di assistenza: cc@roho.com

Nota: Se si devono restituire articoli, inviare a:
ROHO, Inc., 1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223

Fuori dagli U.S.A: intl@roho.com • Telefono: 618-277-9150 • Fax: 618-277-6518
O visitare www.roho.com per un elenco di tutti i distributori internazionali ROHO.

Garanzia limitata
Cosa copre? ROHO, Inc. copre qualsiasi difetto dei materiali o di fabbricazione del prodotto.

Per quanto tempo? Dalla data di acquisito originale, 24 mesi.

Cosa non copre? Un prodotto che non è stato usato correttamente, che è stato danneggiato incidentalmente o danneggiato da "un'azione della Natura", ad es., inondazione, tornado, terremoto, incendio. Qualsiasi sostituzione degli accessori forniti o qualsiasi modifica del prodotto invalideranno la garanzia.

Cosa deve fare il cliente: Negli U.S.A. il cliente deve contattare il reparto Servizio Garanzia di ROHO, Inc. Nota: Qualsiasi articolo spedito a ROHO, Inc. senza previa autorizzazione non sarà restituito al cliente. Fuori dagli USA, contattare il distributore ROHO del vostro paese.

Domande? Vedere Informazioni Di Contatto.

Declinazione di responsabilità: Qualsiasi garanzia implicita, compresa la COMMERCIABILITÀ E L' IDONEITÀ AD UN FINE PARTICOLARE è limitata allo stesso periodo di tempo dei tipi di prodotto indicati sopra nel paragrafo "Per quanto tempo?" e qualsiasi azione per la violazione di tali garanzie o di qualsiasi garanzia qui espressa deve essere iniziata entro quel periodo di tempo. ROHO, Inc. non sarà responsabile di nessun danno incidentale o consequenziale rispetto a perdite economiche, derivanti da violazione di garanzie espresse o implicite o diversamente.

I vostri diritti e l'effetto di questa garanzia su di essi. Questa garanzia limita la durata di tutte le garanzie implicite come indicato sopra e limita o esclude il recupero per danni incidentali o consequenziali. Alcune giurisdizioni non consentono i limiti sulla durata della garanzie implicite e alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di danni consequenziali o incidentali, quindi queste misure potrebbero non essere applicabili nel vostro caso. La presente garanzia vi riserva diritti legali specifici ma potreste avere altri diritti che variano da giurisdizione a giurisdizione.

ROHO®

Mailing/Shipping Address:
1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900 USA

Administrative Offices:
100 N. Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429 USA
U.S.: 800-851-3449 • Fax 888-551-3449
Outside the U.S.: 618-277-9150 • Fax 618-277-6518

www.roho.com

C ETL CM US LISTED
Intertek

CERTIFIED
INTERTEK
ISO 13485:2003

CERTIFIED
INTERTEK
ISO 9001:2008
ANAB ACCREDITED

The Quality Management System
of ROHO, Inc. is certified to
ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003.

EC REP
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

CE

T20185
Revision: 4/1/15
Print Date: Qty: